Améliorez la précision et organisez votre traçabilité

Evitez les erreurs de traçabilité.

Du fait de l'activité intense du service de stérilisation, les risques d'erreurs de traçabilité et d'enregistrement peuvent être nombreux. Améliorez la fiabilité et organisez l'archivage en connectant l'incubateur 3M™ Attest™ 490H à votre système de traçabilité.

Les résultats des indicateurs biologiques et d'autres informations stratégiques peuvent automatiquement être déversés dans votre système.**

Stérilisation au peroxyde d'hydrogène. Une approche intégrée de la surveillance.

Tous les produits de surveillance du procédé de stérilisation par le peroxyde d'hydrogène possèdent le même indicateur coloré qui vire du bleu vif au rose. Facile à utiliser et facile à interpréter.

Ruban indicateur

Le ruban indicateur d'exposition pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène 3M™ Comply™ 1228 confirme que l'instrumentation emportée au bloc opératoire a bien été exposée au procédé de stérilisation.



Indicateur chimique

L' indicateur pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène 3M™ Comply™ 1248 permet au personnel du bloc opératoire de vérifier que les conditions de stérilisation ont été réunies à son point de placement.

Indicateur biologique

L'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ 1295, quand il est utilisé avec le lecteur 3M™ Attest™ 490H, démontre la létalité du cycle de stérilisation.

Prenez le contrôle pour une plus grande sérénité.

Avec un résultat en 4 heures seulement, vous connaissez les résultats des indicateurs biologiques avant de libérer le lot, améliorant ainsi la sécurité du patient dans votre établissement.

Découvrez comment intégrer l'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène dans votre pratique quotidienne.

Solutions 3M pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène.

	Référence	Description	Sous-conditionnement	Conditionnement
	1295	**Indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène**	30 unités / sachet	4 sachets / carton
	490H	**Incubateur 3M™ Attest™** à utiliser avec l'Indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène. Cable ethernet pour la connectivité de l'interface web inclus.	1 unité / boîte	1 boîte / carton
	1248	**Indicateur pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène 3M™ Comply™** L'indicateur chimique vire du bleu vif au rose après exposition au peroxyde d'hydrogène 2 cm x 10 cm	250 unités / sachet	4 sachets / carton
	1228	**Ruban indicateur pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène 3M™ Comply™** Les stries du ruban indicateur virent du bleu vif au rose après exposition au peroxyde d'hydrogène 19 mm x 55 m		24 rouleaux / carton

Pour utilisation dans les stérilisateurs STERRAD modèles 100NX (cycles standard, Flex, Express et Duo), NX (cycles standard et Avancé) et 100S.

Contactez votre délégué commercial 3M ou visitez notre site go.3M.com/VH2O2

A DÉCOUVRIR BIENTÔT!

Vous pourrez bientôt obtenir les résultats de l'indicateur biologique pour les cycles de stérilisation par vaporisation de peroxyde d'hydrogène en seulement.*

Dès l'obtention de l'autorisation de la FDA, tous les clients qui utilisent notre système en 4 heures pour VH2O2 pourront migrer aisément vers le nouveau système.

* Résultats en 24 minutes dans l'attente de l'autorisation 510(k)

** Approuvé par la FDA pour les stérilisateurs STERRAD modèles 100NX (cycles standard, Flex, Express et Duo), NX (cycles standard et Avancé) et 100S. Il peut être également utilisé dans d'autres appareils comme le STERIS V-PRO.

3M (Suisse) S.à r.l.
Médecine
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Téléfon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare

IPD-000942 - septembre 2016 - Photos non contractuelles.

3M, Attest et Comply sont des marques déposées de 3M. Sterrad est un marque déposée de Advanced Sterilization Products, Division d'Ethicon US, LLC. V-Pro est une marque déposée de STERIS Corporation.

3M Science. Applied to Life.™*

Indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™.

Solutions pour le contrôle de la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène.

Efficacité, fiabilité et maîtrise.

A DÉCOUVRIR BIENTÔT!

Résultats de l'indicateur biologique (BI) pour VH202 en 24 minutes.*

*3M Science. Au service de la Vie.

Technologie de lecture rapide pour lire les résultats des indicateurs biologiques en 4 heures seulement.

La technologie maîtrisée de lecture rapide des indicateurs biologiques 3M est maintenant disponible pour le contrôle des procédés de stérilisation par le peroxyde d'hydrogène. Approuvé par la FDA pour STERRAD et pouvant également être utilisé dans d'autres appareils tels que le V-PRO.

L'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ rend le contrôle de la stérilisation plus facile. Mis en avant dans la norme EN ISO 14161, le système procure aux patients la meilleure sécurité.

Placez l'indicateur biologique dans un sachet de stérilisation ou dans un dispositif d'épreuve de procédé (DEP).

Etre conforme aux normes

Les normes indiquent que si on ne peut pas mesurer l'ensemble des paramètres critiques du procédé, il faut vérifier l'efficacité du procédé en utilisant un indicateur biologique. Les pratiques actuelles exigent une rotation rapide des articles à stériliser, ce qui rend difficile l'observance des normes. Les nouveaux indicateurs biologiques 3M Attest permettent une lecture en 4 heures, apportant la preuve que les conditions de stérilisation ont été réunies avant que les articles ne soient libérés et utilisés au bloc opératoire.

C'est une question de confiance.

Depuis des décennies, des services de stérilisation comptent sur les indicateurs biologiques de stérilisation 3M™ pour contrôler la stérilisation par la vapeur d'eau, avec plus de 850 millions de cycles contrôlés par 3M Attest de par le monde.

Aujourd'hui, la même technique est disponible pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène.

Savoir plus rapidement pour répondre plus vite

Les indicateurs biologiques 3M à lecture rapide 3M Attest vous fournissent l'information dont vous avez besoin, avant que vous ne libériez le lot

Simplifier le flux

Avec des résultats plus rapides et l'interface conviviale de l'incubateur 3M™ Attest™ 490H, vous pouvez documenter les résultats le jour même, sans attendre l'équipe suivante.

Découvrez comment intégrer l'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ pour la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène dans votre pratique quotidienne.

Les indicateurs biologiques à lecture rapide 3M™ Attest™ peuvent maintenant fournir des résultats rapides pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène.

Anatomie de l'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™.

Dans ce petit tube, il y a plus d'un million de spores de Geobacillus stearothermophilus qui permettent une lecture en quatre heures pour le procédé de stérilisation H_2O_2, six fois plus vite que d'autres indicateurs.

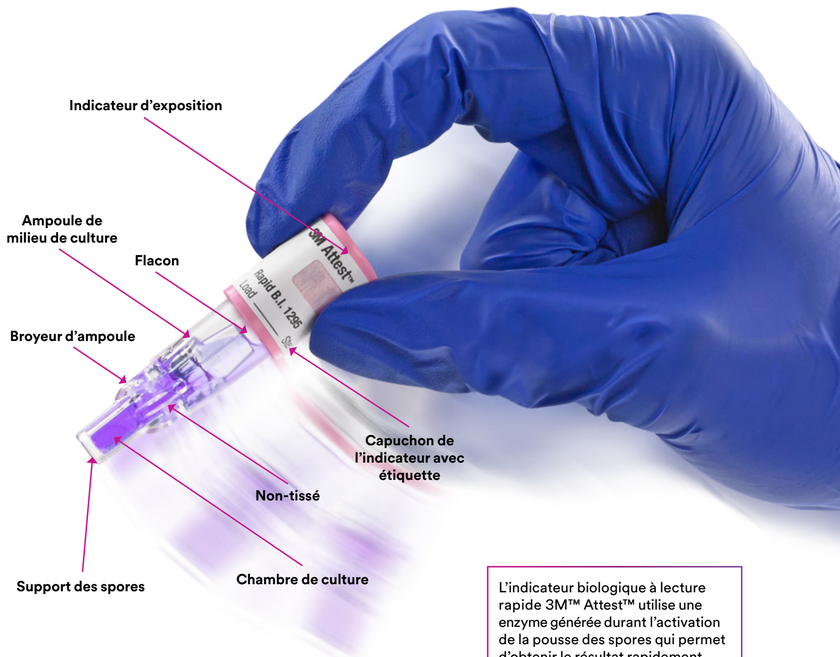

L'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ Attest™ utilise une enzyme générée durant l'activation de la pousse des spores qui permet d'obtenir le résultat rapidement.