

3M Science.
Applied to Life.™



3M Health Information Systems

Qualitätssicherung mit 3M™ QS-MED Suite

Zusatzmodul Falldatenabgleich

Hintergrund

Mit der gesetzlichen Forderung der 100-prozentigen Dokumentationspflicht wird die Transparenz in der QS-Dokumentation innerhalb eines Krankenhauses immer wichtiger. Zu jeder Zeit – aber vor allem im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten – muss die Möglichkeit bestehen, die dokumentierten QS-Daten mit den Abrechnungsdaten (nach §21) abzugleichen, die auch bei der Erstellung der Sollstatistik als notwendiges Soll herangezogen werden.

Mit dem *3M QS-MED Suite Modul Datenkorrektur* besteht die Möglichkeit, die QS-Daten mit den §21-Daten abzugleichen und bei Bedarf zu korrigieren, zu jeder Zeit mit aktuellen Daten, übersichtlich und bequem.

Dabei wird der Exportstatus des Bogens berücksichtigt und wieder hergestellt, die Korrekturergebnisse werden zusammengefasst und alle Änderungen an den Bögen geloggt.

Abgeglichen und korrigiert werden können bisher die Felder

- Entlassender Standort
- Aufnahme datum
- Entlassungsdatum
- Entlassungsgrund
- IK der Krankenkasse
- Versicherten-ID


Installation und Lizenzierung

Eine gesonderte Installation ist nicht notwendig, da das Modul in der normalen QS-MED Suite Installation mit ausgeliefert wird.

Die Nutzung wird über einen separaten Eintrag in der Lizenzdatei gesteuert, die Sie nach dem Erwerb des Moduls erhalten.

Nutzung

Zugriff zu dem Modul erhalten nur die Benutzer, bei denen die entsprechende Berechtigung vorliegt. Diese ist in der Benutzerverwaltung unter Drucken/Statistik zu aktivieren:

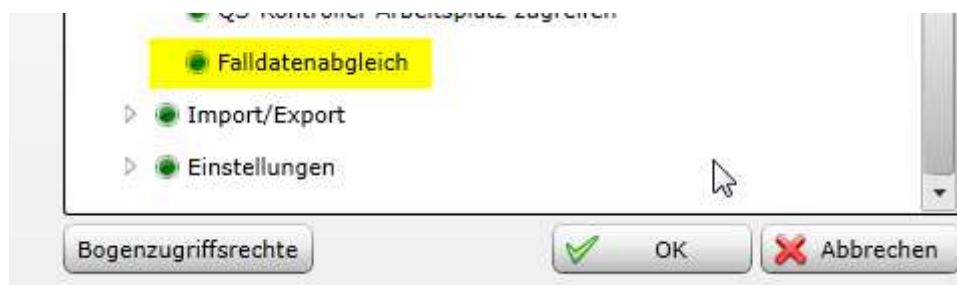

Sie starten das Modul wie gewohnt über die Benutzeroberfläche der 3M QS-MED Suite über den Button *Falldatenabgleich*.



Bei Aufruf des Moduls wird ein Abgleich der zuletzt importierten §21-Daten / QS-Filterdatenbank (i.s.h.med) mit den aktuellen QS-Daten gestartet. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



Bei Nutzung des importierten §21-Datensatzes ist die Aktualität der Daten von Ihrer Importroutine abhängig. Nutzen Sie den automatischen §21-Import täglich, stehen Ihnen stets aktuelle Informationen zur Verfügung. Das Modul nutzt die §21-Daten, die Sie sowieso in die QS-MED Suite installieren.

Nach der vollständigen Analyse werden alle Bögen mit Abweichungen angezeigt.


Status	Modul	Aufnahmenr.	Patientenname	Entlassender Standort		Aufnahmedatum		Entlassungsdatum		Entlassungsgrund	
				Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
		09/6 - 2016 096_190_0000072		01	01	14.09.2016	14.09.2016	25.05.2017	25.05.2017	02	08
		09/6 - 2016 096_190_0000073		01	07	04.01.2016	04.01.2016	24.03.2016	24.03.2016	01	05
		09/6 - 2016 096_190_0000074		01	01	07.06.2016	23.10.2016	23.01.2017	23.01.2017	02	06
		09/6 - 2016 096_190_0000075		01	06	05.11.2016	27.11.2016	20.02.2017	20.02.2017	02	05
		09/6 - 2016 096_190_0000076		01	01	12.05.2016	12.05.2016	21.12.2016	25.05.2016	02	05
		09/6 - 2016 096_190_0000077		01	06	03.02.2016	03.02.2016	02.02.2017	03.03.2016	01	06
		09/6 - 2016 096_190_0000078		01	01	06.05.2016	20.04.2016	29.03.2017	18.05.2016	02	07
		09/6 - 2016 096_190_0000079		01	03	12.11.2016	17.03.2016	28.07.2017	19.07.2016	02	05
		09/6 - 2016 096_190_0000081		01	08	04.06.2016	04.06.2016	16.10.2016	16.10.2016	03	03
		09/6 - 2016 096_190_0000082		01	01	12.03.2016	18.06.2016	29.04.2016	29.04.2016	02	02
		09/6 - 2016 096_190_0000083		01	05	11.01.2016	27.08.2016	16.01.2017	16.01.2017	02	02
		09/6 - 2016 096_190_0000084		01	01	01.08.2016	01.08.2016	24.10.2016	27.05.2017	02	02
		09/6 - 2016 096_190_0000085		01	02	08.09.2016	08.09.2016	17.09.2016	13.10.2016	01	01
		09/6 - 2016 096_190_0000086		01	01	06.03.2016	21.09.2016	24.08.2016	04.06.2017	02	02
		09/6 - 2016 096_190_0000087		01	08	09.02.2016	26.01.2016	06.02.2017	09.05.2016	01	01
		09/6 - 2016 096_190_0000088		01	01	08.04.2016	08.04.2016	14.11.2016	14.11.2016	03	05
		09/6 - 2016 096_190_0000089		01	02	04.08.2016	04.08.2016	28.01.2017	28.01.2017	03	07
		09/6 - 2016 096_190_0000090		01	01	01.05.2016	19.03.2016	19.05.2017	19.05.2017	01	06
		09/6 - 2016 096_190_0000091		01	07	11.04.2016	20.11.2016	13.03.2017	13.03.2017	01	08

Folgende Funktionen sind verfügbar:


1. Standardmäßig werden bei Start des Moduls vorhandene Abweichungen angezeigt.
2. Sie können die Felder auswählen, welche für eine Korrektur abgeglichen werden sollen.
3. Die Felder, die Sie links auswählen, werden rechts in der Bogenübersicht als Spalten dargestellt. Die Auswahl der abzugleichenden Felder wird benutzerbezogen gespeichert und beim nächsten Aufruf genutzt.
4. Die Auswahl der angezeigten Bögen erfolgt verfahrensjahrbezogen. Berücksichtigt werden alle Fälle, die
 - a. Im ausgewählten Jahr aufgenommen oder
 - b. Im Vorjahr aufgenommen und im ausgewählten Jahr entlassen wurden.
5. Es wird angezeigt, welche Quelle für die §21-Daten genutzt wird. Sollten sowohl Daten aus der QS-Filter DB (nur Cerner i.s.h.med) als auch importierte Daten vorliegen, kann die Quelle ausgewählt werden.
6. Es werden nur Bögen angezeigt, bei denen in mindestens einem der ausgewählten Felder eine Abweichung vorliegt (auch leere Felder). Abweichungen im *Ist* werden rot dargestellt.
7. Die Spalten Modul, Aufnahme- und Patientennamen können auf- und absteigend sortiert werden.
8. Die Liste der Bögen kann wie im Bereich der QS-Dokumentation bearbeitet werden. Bögen können je nach Status gelöscht, freigegeben, storniert oder korrigiert werden. Mehrere Bögen können markiert werden und die Liste der Bögen kann gespeichert bzw. gedruckt werden.
9. Wurde ein oder mehrere Bögen markiert, können die abweichenden Felder korrigiert werden.

Bogenkorrektur

Wurden Bögen zur Korrektur ausgewählt und der Button „Ausgewählte Bögen korrigieren“ gedrückt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

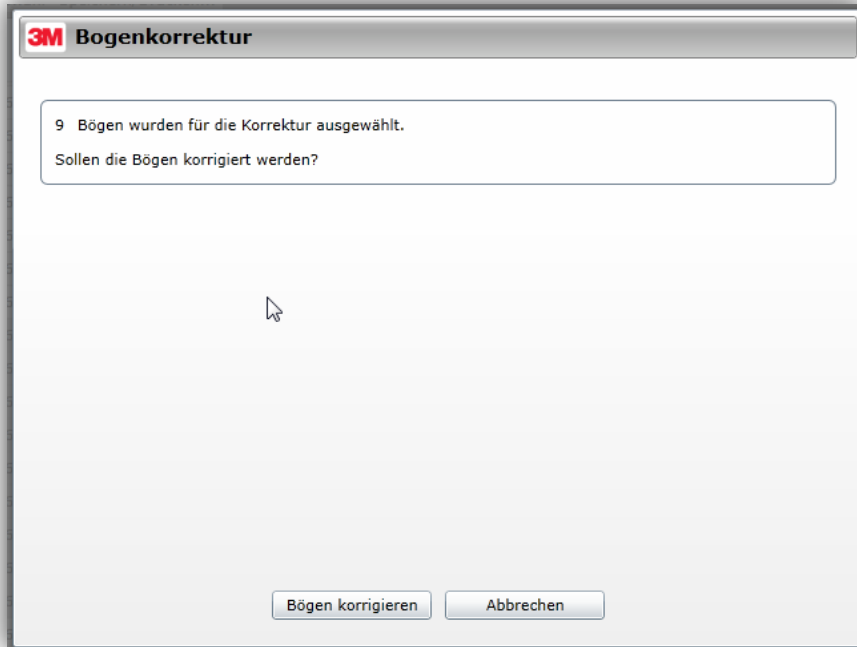

Wird diese bestätigt, erfolgt die Bogenkorrektur.

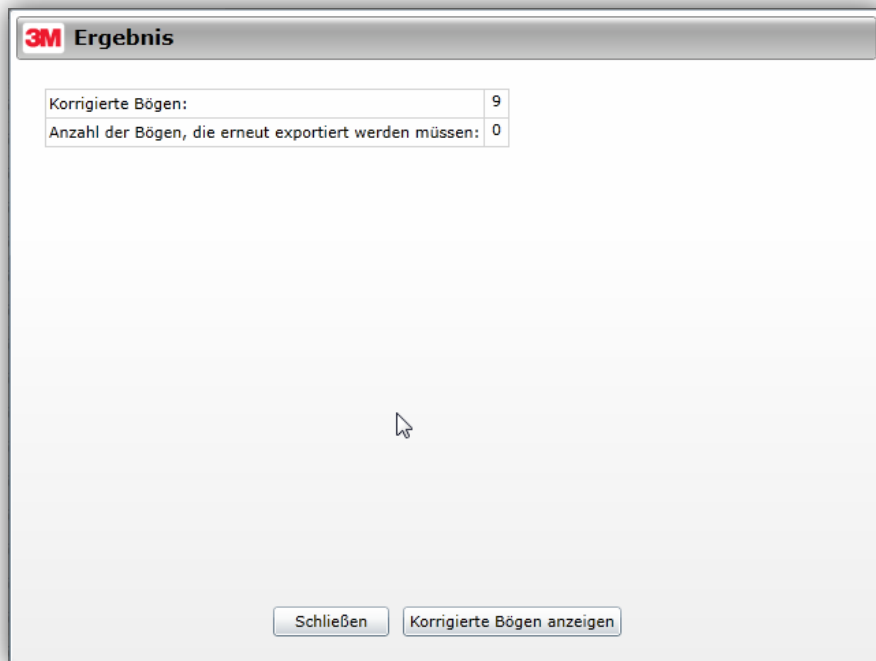

Freigegebene Bögen werden korrigiert und befinden sich auch nach der Korrektur im Status „freigegeben“. Bereits exportierte Bögen werden separat ausgewiesen. Diese Bögen müssen nach der Korrektur erneut exportiert werden!

Die korrigierten Bögen können anschließend direkt eingesehen werden. Alternativ können alle Korrekturen unter dem Reiter „Ergebnisse“ eingesehen werden.

Ergebnisse

Reexport notwendig	Status	Fehlerstatus	Modul	Aufnahmenr.	Patientenname	Aufnahmedatum		Entlassungsdatum	
						War	Ist	War	Ist
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000075		19.06.2016	12.04.2016	15.01.2017	03.10.2017
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000076				16.06.2016	25.04.2016
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000077				09.03.2017	22.06.2017
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000078		25.03.2016	07.09.2016	26.08.2017	15.08.2016
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000079		20.10.2016	04.01.2016		
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000082		18.01.2016	08.05.2016		
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000083		27.10.2016	08.01.2016		
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000084				15.02.2017	25.05.2017
<input type="checkbox"/>			65/3 - 5.0	653_110_000085				23.12.2016	07.12.2017

1. Die korrigierten Bögen werden unter dem Reiter „Ergebnisse“ abgebildet.
2. Es ist möglich, die Ansicht der korrigierten Bögen zu filtern:
 - a. Alle korrigierten Bögen
 - b. Alle Bögen der letzten Korrektur
 - c. Alle Bögen, die erneut exportiert werden müssen (Spalte „Reexport notwendig“ markiert)
3. Alle korrigierten Bögen werden in die Liste geschrieben. Zum Leeren der Liste nutzen Sie den Button „Liste zurücksetzen“
4. Auch aus dieser Ansicht können die Bögen bearbeitet, markiert und direkt exportiert werden.

Alle Änderungen an den Bögen werden wie gewohnt im Bogenlogbuch geloggt.

Kontakt

3M Health Information Systems

Hammfelddamm 11

D-41453 Neuss

Tel. +49 (0) 21 31 / 14-4241

Fax. +49 (0) 21 31 / 14-4242

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Ohne Gewährleistung oder Haftung für die Richtig- und Vollständigkeit des Dokuments. Bei Fragen oder Anregungen zum Dokument schreiben Sie bitte eine E-Mail an:

E-Mail: HIS-Support@mmm.com

<http://www.3M.de/his>