

Modificação da Placa de Alta Sensibilidade 3M™ Petrifilm™ para Contagem de Coliformes

Prezado cliente,

Como parte da estratégia de Sustentabilidade 3M, a 3M Food Safety decidiu remover o Guia de Referência Rápida e Certificação de Garantia de Qualidade das caixas dos nossos produtos. Tal aprimoramento é orientado pela nossa promessa de favorecer soluções sustentáveis para testes microbiológicos.


Nas próximas semanas, você começará a receber nossos produtos sem o Guia de Referência Rápida e Certificação de Garantia de Qualidade ora contido nas caixas. Como processo de remoção destes documentos, nós aprimoramos a disponibilidade dos Certificados de Análise online. Além das informações contidas nas Certificações de Garantia de Qualidade, os Certificados de Análise contêm detalhes dos nossos testes de garantia de qualidade para liberação do produto. Para receber um Certificado de Análise, favor utilizar o link disponível abaixo:

https://www.3m.com/3M/en_US/food-safety-us/resources/certificates/

Instruções de como utilizar o recurso de busca:

- 1** Digite o número de Estoque (Stock number, destacado na imagem abaixo) ignorando os traços.
- 2** Digite o número do Lote (Lot number, como na imagem) exatamente como impresso no produto, incluindo os traços, maiúsculas e espaços.
- 3** Pressione “search” e clique na lupa quando os resultados aparecerem para visualizar o certificado de interesse.

Caso nenhum resultado apareça, favor enviar um pedido de certificado na parte inferior da página.

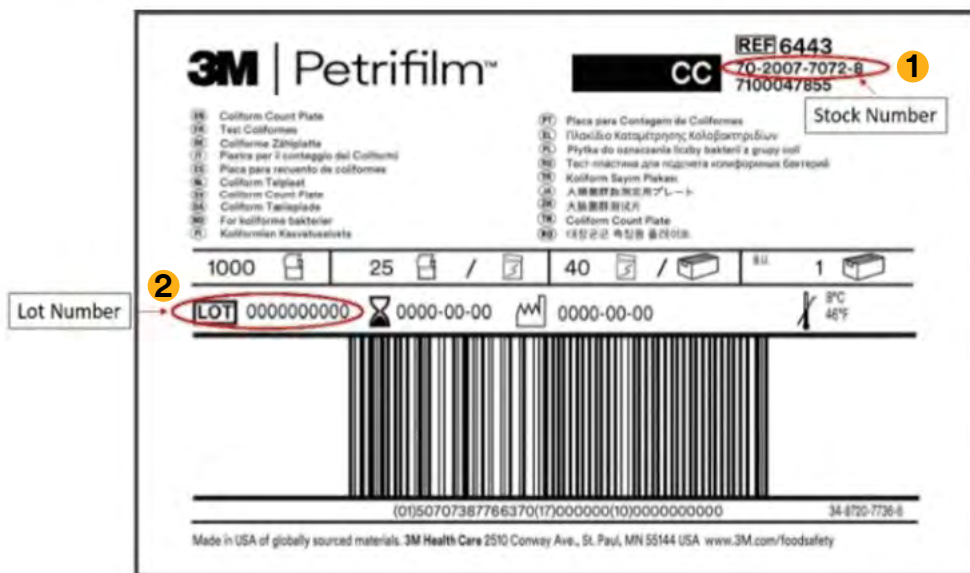

Obrigado pelo seu contínuo uso e suporte às Placas 3M™ Petrifilm™ ao longo dessa nova revitalização, e esperamos que sua experiência com o uso das Placas 3M™ Petrifilm™ nos seus testes microbiológicos seja aprimorada por essa mudança. Caso haja alguma dúvida a respeito deste assunto, por favor contate seu representante regional da 3M Food Safety.

Atenciosamente,
3M do Brasil